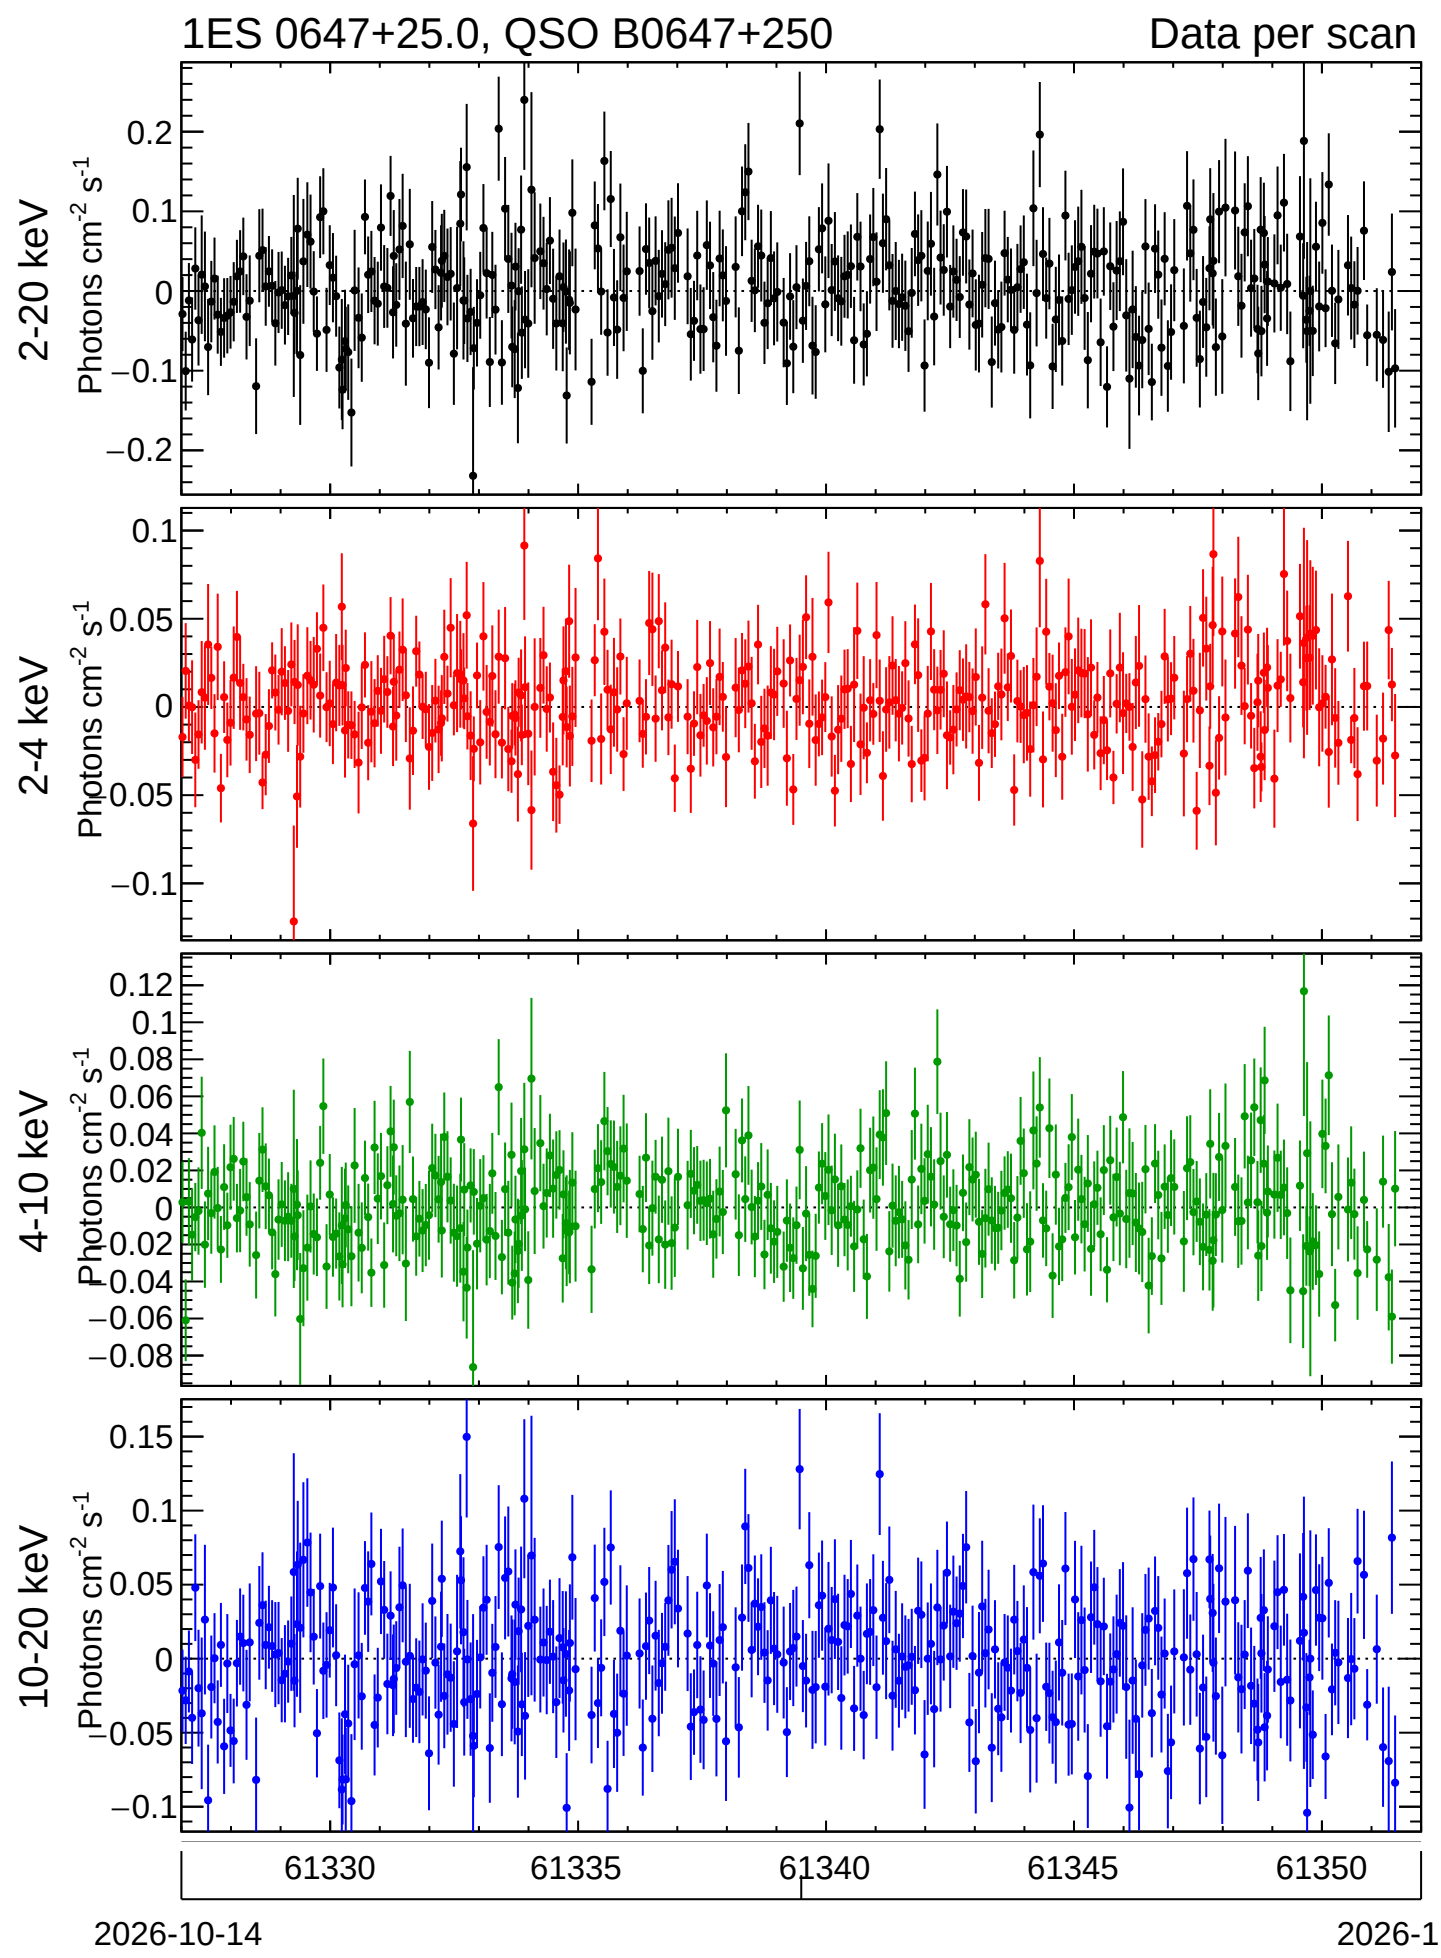
1ES 0647+25.0, QSO B0647+250
Data per scan
2-20 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
2-4 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
4-10 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
10-20 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.15
0.1
0.05
0
−0.05
−0.1
61330
61335
61340
61345
61350
2026-10-14
2026-11-08