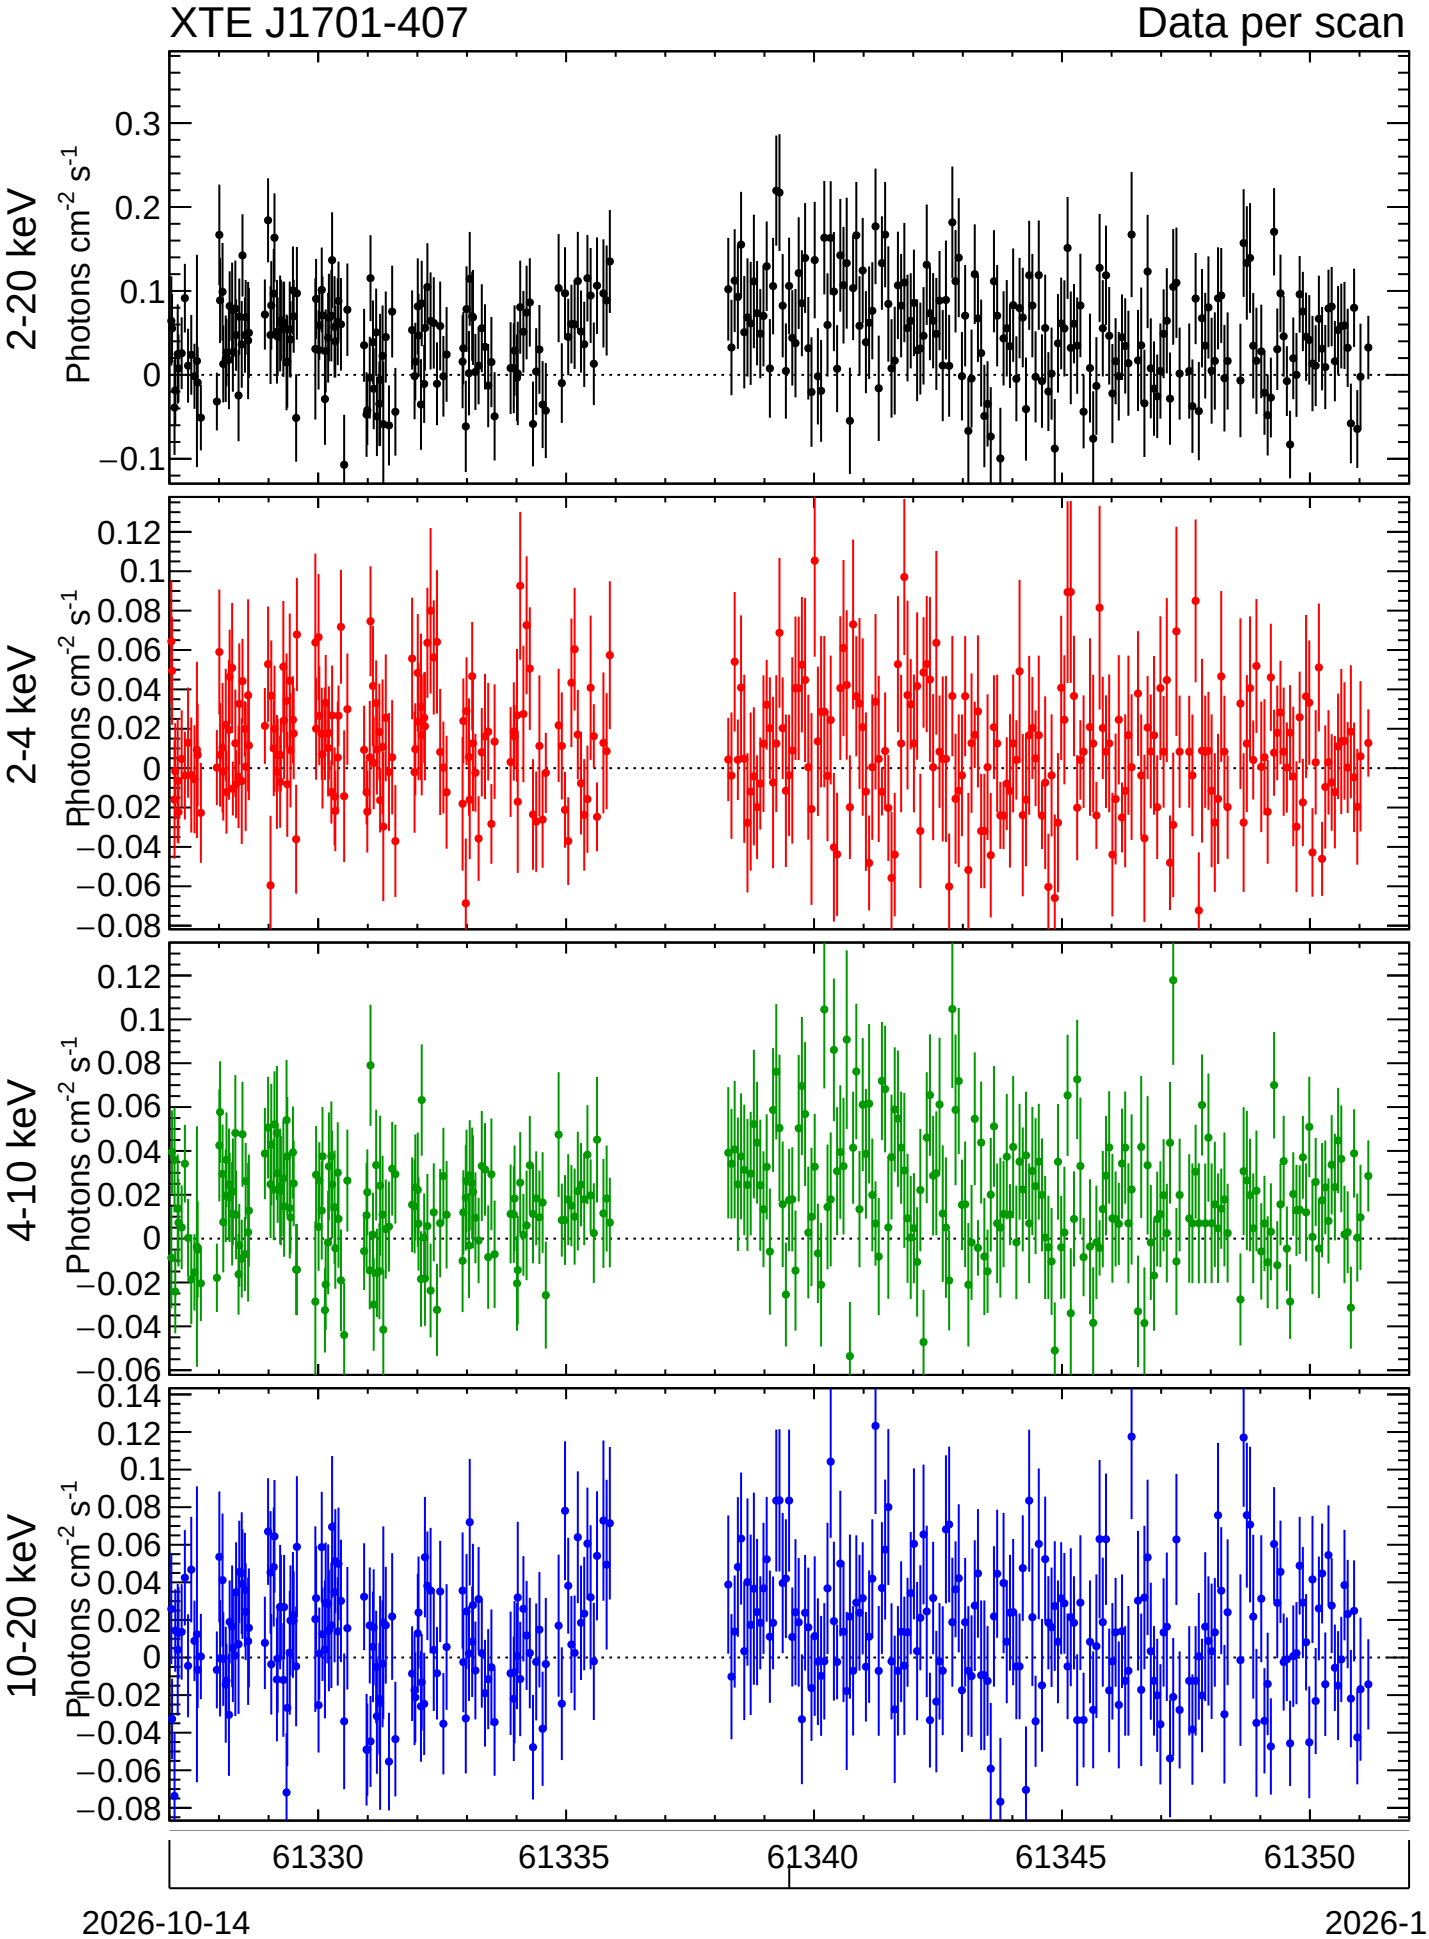
XTE J1701-407
Data per scan
2-20 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
2-4 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
4-10 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
10-20 keV
Photons cm^{-2} s^{-1}
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
61330
61335
61340
61345
61350
2026-10-14
2026-11-08